TOMTAR®

NL

Gebruiksaanwijzing versie 5.0.0 NL

Rollator XXL

Hartelijk dank voor uw keuze voor de XXL-rollator van DIETZ.

De XXL-rollator is stabiel, licht en inklapbaar. Hij ondersteunt bij alle wandelingen en boodschappen en biedt op het juiste moment een plekje om te kunnen zitten en uitrusten.
Lees eerst deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om alle functies van de rollator te leren kennen.

Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de leveringsomvang. De eigenaar moet deze bewaren en ook doorgeven bij het doorgeven van het product.
Wijzigingen door technische ontwikkelingen ten opzichte van de in deze gebruiksaanwijzing getoonde uitvoeringen voorbehouden.

Voor deze gebruiksaanwijzing worden aanpassingen niet doorgegeven. De actuele geldige versie kunt u bij ons verkrijgen.

Voor het kopiëren, vertalen en verveelvoudigen in welke vorm dan ook, ook gedeeltelijk, is de schriftelijke toestemming van de fabrikant noodzakelijk. Pa dis perferitam hil ea conectibus.

OPMERKING

Als u de gebruiksaanwijzing in groter formaat wilt inzien, kunt u deze via **www.dietz-rehab.de** downloaden in pdf-formaat.



01 Belangrijke informatie

Gebruiksdoel 4
Indicatie 4
Contra-indicaties 4
Tekens en symbolen 4

02 Productbeschrijving

Leveringsomvang 5
Optionele accessoires 5
Opbouw van de XXL-rollator 5

03 Rollator opbouwen

Rollator opstellen / openklappen 6
Handvathoogte instellen 6
Rugbeugel bevestigen 7

04 Rollator gebruiken

Lopen met de rollator 8
Remmen 8
Remmen instellen 9
Zitten / Rugbeugel gebruiken 9
Rollator inklappen 10

05 Accessoires / Hulpstukken

Mandje (standaard meegeleverd) 10
Eenhandsrem (optioneel) 10
Paraplu (optioneel) 11
Onderdelen en accessoires van derden 11

06 Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinstructies 12

07 Opmerkingen over het gebruik

Reparatie/onderhoud 14
Onderhoudsplan XXL-rollator 14
Problemen vaststellen en verhelpen 16
Reiniging 17
Desinfectie 17
Doorgifte en hergebruik 17
Opslag 18
Recycling 18

08 Fabrikantverklaringen

Productkenmerking 18
Garantie 19
Levensduur 19
Aansprakelijkheid 19

09 Technische documentatie

Afmetingen en technische gegevens 20
Productcontroles 21
Omgevingsvoorwaarden 21
Bepaling van de identificatiegegevens 21

GEBRUIKSDOEL

De XXL-rollator dient als loophulp en gedeeltelijk ook als zitgelegenheid om even uit te rusten voor personen met beperkte mobiliteit tot maximaal 200 kg lichaamsgewicht.
De onder de zitting geplaatste draadmand is bedoeld voor het bewaren en vervoeren van voorwerpen of goederen.

De XXL-rollator is bedoeld voor thuisgebruik en (poli)klinisch gebruik en mag uitsluitend worden gebruikt op een vaste en vlakke ondergrond.

Het beoogde gebruik kan afwijken bij producten die op maat zijn gemaakt (custom-made device). Dit wordt in zo'n geval aangegeven. In dat geval moet ook de met dat product meegeleverde documentatie worden geraadpleegd.

INDICATIE

De XXL-rollator dient te worden gebruikt bij

- loopmoeilijkheden als gevolg van beperkingen van het actieve of passieve bewegingsapparaat
- coördinatieproblemen tijdens de loopfase
- verminderde belastbaarheid

CONTRA-INDICATIES

De XXL-rollator mag niet worden gebruikt bij

- waarnemingsstoornissen
- ernstige evenwichtsstoornissen
- een lichaamsgewicht van meer dan 200 kg

De rollator is niet geschikt voor kinderen.
De XXL-rollator mag niet worden gebruikt als opstaphulp, transporthulp voor grote lasten/personen of vergelijkbare doeleinden.

TEKENS EN SYMBOLEN

Deze symbolen wijzen op tekstpassages die nuttig zijn voor het alledaagse gebruik van dit product.

WAARSCHUWING

Waarschuwingen moeten altijd worden opgevolgd!
We wijzen u erop dat bij niet-naleving letselgevaar kan ontstaan en/of schade aan de rollator of de omgeving kan worden toegebracht.

OPMERKING

Tips en suggesties die het gebruik makkelijker maken.

LEVERINGSOMVANG

Met de XXL-rollator worden de volgende onderdelen en accessoires meegeleverd:

- XXL-rollator
- Gebruiksaanwijzing
- Mandje
- Rugbeugel

De XXL-rollator wordt gebruiksklaar gemonteerd geleverd. Controleer na het uitpakken of de rollator volledig en onbeschadigd is.Als de inhoud herkenbaar beschadigd is, moet dit onmiddellijk worden gemeld bij de transporteur.

OPTIONELE ACCESSOIRES

Voor uw XXL-rollator zijn de volgende accessoires verkrijgbaar:

- Eenhandsrem
  art.nr. 290107 (links)
  art.nr. 290108 (rechts)
- Paraplu voor zon- en regenbescherming
  art.nr. 601270 (rood)
  art.nr. 601271 (macchiato)

OPBOUW VAN DE XXL-ROLLATOR

1. Remhendel
2. Ergonomische handvatten
3. Remkabel
4. Rugbeugel
5. Zitting
6. Haak, mandje
7. Bevestigingsbeugel, mandje
8. Mandje
9. Voorwielen, draaibaar
10. Grijpstang, in hoogte verstelbaar
11. Draaiknop
    voor hoogteverstelling
12. Blokkeerpen, rugbeugel
13. Rem
14. Achterwielen, vast

De XXL-rollator wordt volledig gemonteerd geleverd. In de volgende hoofdstukken wordt omschreven hoe de rollator moet worden opgebouwd en aan uw wensen kan worden aangepast, zodat u deze comfortabel kunt gebruiken.

ROLLATOR OPSTELLEN / OPENKLAPPEN

1. Plaats de rollator voor u in de gewenste rijrichting en schakel de blokkeerrem in door de remhendels omlaag te drukken. (zie hoofdstuk "Remmen")
2. Houd één hand op de handgreep van de rollator.
3. Druk met de andere hand de zitting omlaag totdat deze hoorbaar vastklikt.
4. Hang het mandje met de haak vanaf de voorkant op het frame. (Zie "Opbouw van de XXL-rollator")

WAARSCHUWING

Gebruik de rollator uitsluitend als de zitting correct is vastgeklikt. Als de zitting is vastgeklikt, wordt de rollator in uitgeklapte toestand vergrendeld

WAARSCHUWING

Pas bij het uit- en inklappen van de rollator op uw handen, vingers en kledingstukken! Er bestaat beknellingsgevaar!

HOOGTE VAN DE HANDVATTEN INSTELLEN

1. Zet de blokkeerrem vast. (zie hoofdstuk "Remmen")
2. Draai de draaiknop los en draai de schroef er volledig uit.
3. Plaats vervolgens de handvatten op de gewenste hoogte.
4. Breng de schroef vervolgens weer in en draai deze vast met de draaiknop.

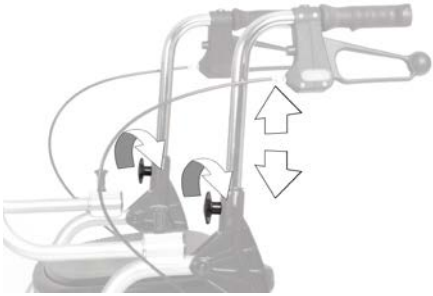

WAARSCHUWING

Let erop dat de schroeven volledig in het schroefgat zitten en goed vastzitten.

OPMERKING

De XXL-rollator moet op uw lengte worden ingesteld voordat u deze correct kunt gebruiken. Deze instelling moet door een geschoold persoon worden uitgevoerd.

RUGBEUGEL BEVESTIGEN

1. Trek eerst de vergrendelpen omhoog door deze iets te draaien, zodat de vergrendeling wordt opgeheven.
2. Schuif nu de bevestigingsuiteinden van de rugbeugel in de daarvoor bedoelde gaten.
3. Vervolgens kunt u de vergrendelpen in de vergrendelde stand draaien zodat de rugbeugel vastzit.
4. Voor het verwijderen van de rugbeugel voert u deze stappen in omgekeerde volgorde uit.

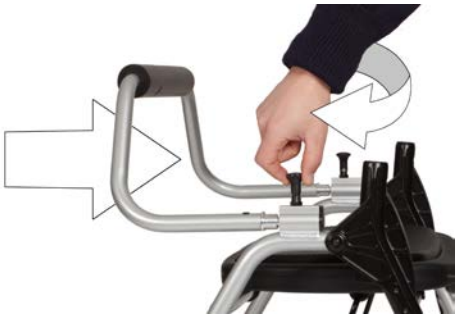

WAARSCHUWING

Controleer telkens voordat u de rollator gaat gebruiken of de rugbeugel is vergrendeld en vastzit.

Maak uzelf voor het eerste gebruik vertrouwd met uw XXL-rollator, zodat u zich veilig voelt tijdens het gebruik. In dit geval adviseren wij om een begeleider in te schakelen.

Voordat u de rollator gaat gebruiken, moet u controleren of deze correct is gemonteerd:

- Zijn alle onderdelen goed bevestigd?
- Zijn alle schroeven vastgedraaid?
- Functioneren de remmen?
- Staat de rollator op alle vier de wielen?
- Is de zitting volledig ingebracht en vergrendeld?

LOPEN MET DE ROLLATOR

Ga achter de rollator staan en pak de schuifhandvatten met beide handen vast. Als u stevig staat, lost u beide remmen. Nu kunt u gaan lopen.

WAARSCHUWING

De volgende punten hebben betrekking op de veiligheid!

- Schuif de rollator niet te ver voor u uit. Voor een goede ondersteuning moet de rollator dicht bij het lichaam blijven.
- Beheers het tempo eventueel door beide remhendels licht en gelijkmatig in te knijpen. (zie volgend hoofdstuk)
- Loop rechtop en kijk vooruit, zodat u hindernissen op tijd waarneemt en er omheen kunt rijden.
- Gebruik de rem op afdalingen (zie volgend hoofdstuk) en gebruik de rollator niet op te steile wegen.
- We raden af om met de rollator achteruit te lopen.

REMMEN

De rem van de XXL-rollator kan op twee manier worden gebruikt:

- als rem tijdens het lopen, zodat u tijdens het lopen gedoseerd kunt remmen.
- als blokkeerrem, om de achterwielen te blokkeren en te zorgen dat de rollator niet kan wegrollen.

1. Om de rollator tijdens het lopen af te remmen, trekt u beide remhendels licht en gelijkmatig naar boven **A**.
2. Om de remmen te blokkeren drukt u beide remhendels omlaag zodat deze worden vergrendeld **B**.
3. Trek de remhendels weer naar boven om de blokkeerrem te ontgrendelen **A**.

REMMEN INSTELLEN

Op deze manier kunt u herkennen of de remmen correct zijn ingesteld:

1. De remhendels en de remkabels mogen niet los zitten (er mag geen sprake zijn van 'speling').
2. Als u de remhendels loslaat, moeten de wielen zonder sleepgeluiden kunnen draaien.
3. Eventueel kan de remwerking met de stelschroef op de remgrepen **A** of op de remblokken van de achterwielen **B** worden ingesteld.

WAARSCHUWING

Draai de stelschroeven er nooit volledig uit, omdat anders de rem niet meer werkt.

WAARSCHUWING

Neem contact op met een geautoriseerde vakhandelaar als u problemen ondervindt bij het instellen van de remmen! Alleen zo kan het veilige gebruik van de rollator worden gegarandeerd.

ZITTEN / RUGBEUGEL GEBRUIKEN

De rugbeugel helpt u bij het vinden van de correcte positie op de gepolsterde zitting.

1. Zet eerst beide blokkeerremmen vast voordat u gaat zitten.
2. Als de rollator niet kan bewegen en het veilig is om te gaan zitten, kunt u zich omdraaien en voorzichtig gaan zitten.

WAARSCHUWING

Controleer telkens voordat u de rollator gaat gebruiken of de rugbeugel is vergrendeld en vastzit.

WAARSCHUWING

Let erop dat de remmen zijn vergrendeld voordat u plaatsneemt en dat de kantelstabiliteit door het leunen tegen de rugbeugel minder wordt.

WAARSCHUWING

De zitting is alleen bedoeld voor korte zitperioden, als u bijvoorbeeld tijdens een wandeling een kleine pauze wilt nemen. Voor langere pauzes adviseren wij u om een gebruikelijke zitgelegenheid op te zoeken!

ROLLATOR INKLAPPEN

De XXL-rollator kan worden ingeklapt zodat deze minder ruimte inneemt als u hem opbergt.

1. Haal het mandje van het frame.
2. Plaats de rollator voor u in de gewenste rijrichting en bedien de blokkeerremmen.
3. Houd één hand op de handgreep van de rollator.
4. Trek met de andere hand de zitting omhoog uit de verankering.
5. Trek de rollator vervolgens helemaal naar u toe zodat hij kan worden ingeklapt.

Om de rollator op te bergen, kunt u de rugleuning en de handvatten verwijderen.

WAARSCHUWING

Pas bij het uit- en inklappen van de rollator op uw handen, vingers en kledingstukken! Er bestaat beknellingsgevaar!

ACCESSOIRES AANBRENGEN EN GEBRUIKEN

Uw XXL-rollator is standaard uitgerust met een winkelmandje en rugbeugel.
Optioneel zijn meer accessoires verkrijgbaar (zie hoofdstuk 'Optionele accessoires').

Alleen originele DIETZ accessoires en onderdelen mogen worden gebruikt. Alleen dan is de overeenstemming en daarmee de veiligheid van het product gegarandeerd.

MANDJE (STANDAARD MEEGELEVERD)

Het mandje is goedgekeurd voor het vervoeren van voorwerpen tot maximaal 3 kg. Zie hiervoor de afbeelding "Opbouw van de XXL-rollator".

1. Om het mandje te bevestigen, gaat u voor de rollator staan.
2. Hang het mandje vanaf de voorkant met de haakjes aan de horizontale verbindingsstang van het frame onder de zitting.
3. Als u het mandje eraf wilt halen, tilt u het mandje zover op dat de haakjes van de framestang zijn losgekomen.
4. U kunt het mandje ook dragen door deze aan de bevestigingsbeugel vast te houden.

EÉNHANDSREM (OPTIONEEL)

Mocht u in een van beide handen over onvoldoende kracht beschikken voor een veilige bediening van de remmen, dan kan de XXL-rollator worden uitgerust met een eenhandsrem.

Deze moet door een geautoriseerde vakhandelaar op de rollator worden gemonteerd.

- Voorwaarde voor het uitrusten met een éénhandsrem is dat u in de hand waarmee u gaat remmen over voldoende kracht beschikt om een veilig gebruik te kunnen garanderen.
- Dezelfde gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn geldig als voor de uitvoering met remhendels aan beide handvatten.

PARAPLU (OPTIONEEL)

Uw XXL-rollator kan worden uitgerust van een paraplu, die tevens dienst kan doen als zonnescherm.
De montage is beschreven in een aparte gebruiksaanwijzing, die bij het accessoire is meegeleverd. Laat het scherm door een geautoriseerde vakhandelaar monteren en vraag naar de gebruiksaanwijzing.

WAARSCHUWING

Door het monteren van een paraplu kan de kantelstabiliteit van de rollator verminderen!

WAARSCHUWING

Neem alle gebruiks- en veiligheidsinstructies in de aparte gebruiksaanwijzing van de paraplu in acht!

HULPSTUKKEN EN ACCESSOIRES VAN DERDE

Over het algemeen is het alleen toegestaan om originele DIETZ GmbH accessoires en onderdelen te gebruiken. Indien er producten van derden op de rolstoel worden geïnstalleerd, gaat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het product over naar de persoon die de accessoires installeert of de installatie uitvoert. De combinatie van accessoires of onderdelen en het DIETZ-product is dan nieuw. De conformiteit hiervan dient verklaard te worden door de persoon die de accessoires of onderdelen monteert. De conformiteit verklaard door DIETZ volgens MDR 2017/745, bijlage II vervalt.

WAARSCHUWING

De veiligheid van het product kan niet worden gegarandeerd als onderdelen of accessoires worden gebruikt die niet door DIETZ worden verkocht.

WAARSCHUWING

Als accessoires of onderdelen aan de rolstoel worden aangebracht, moeten de veiligheidsinstructies in de Gebruikershandleiding voor deze accessoires of onderdelen worden opgevolgd.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij correct gebruik volgens deze gebruiksaanwijzing levert het gebruik van XXL-rollator geen veiligheidsrisico's op.

WAARSCHUWING

Volg alle veiligheidsinstructies op, anders kan er een risico op verwondingen bestaan!

- De rollator mag alleen op een vaste en vlakke ondergrond worden gebruikt!
- Gebruik de bedrijfsrem op wegen die omlaag lopen (trek de remhendels naar boven).
- De rollator moet stevig op alle vier de wielen staan!
- Controleer vóór gebruik van de rollator of alle gemonteerde onderdelen goed vastzitten, of de remmen werken en of de inklapvergrendeling vastgeklikt is.
- Blokkeer altijd beide remmen voordat u op de zitting van de rollator gaat zitten.
- De zitting van de rollator is alleen bedoeld voor korte zitperioden, bijvoorbeeld voor een korte pauze tijdens een wandeling!
- Let op: bij een evenwichtsverschuiving als gevolg van lichaamsbewegingen kan het risico dat de rollator kantelt, groter worden. Let er daarom altijd op dat u de belasting op de rollator gelijkmatig verdeeld!
- Hang geen tassen aan de handvatten of aan andere delen van de rollator, omdat ook hierdoor het kantelrisico toeneemt!
- Pas op uw handen, vingers en kledingstukken tijdens het bedienen van de inklapvergrendeling en het uit- en inklappen van de rollator! Pas op! Beknellingsgevaar!
- Overschrijd nooit de maximale belasting van 200 kg voor gebruiker incl. lading en hulpstukken!
- Stel de rollator niet langdurig bloot aan direct zonlicht of lage temperaturen, omdat onderdelen van het product (bijv. frame, bekleding of handvatten) zeer heet (> 41 °C) of zeer koud (< 0 °C) kunnen worden en daardoor verwondingen aan de huid kunnen ontstaan.
- Zorg ervoor dat de rollator nooit in de directe omgeving van nooduitgangen en vluchtwegen geplaatst wordt en deze blokkeert.
- Gebruik de rollator nooit onder invloed van alcohol of andere middelen die uw aandacht of reactievermogen kunnen beïnvloeden.
- Gebruik de rollator uitsluitend voor het beschreven doel. Rijd er niet ongeremd mee tegen obstakels zoals traptreden of randen.
- Kinderen mogen niet met de rollator spelen; de rollator mag niet in strijd met het beoogde gebruiksdoel worden gebruikt!
- Als u op de rollator zit, mag u deze niet met uw voeten voortbewegen of door andere personen worden geduwd. Hierdoor ontstaat letselgevaar en kan schade aan de rollator worden veroorzaakt.

- Houd u zich op de openbare weg aan de verkeersregels.
- Draag indien mogelijk lichte, opvallende kleding en let erop dat de reflectoren altijd goed zichtbaar zijn. Zo wordt u beter gezien door de andere weggebruikers.
- Gebruik de rollator nooit om op te zitten in het openbaar vervoer of in andere voertuigen. Anders levert dat een verhoogd valrisico op.
- Rij de rollator nooit op een roltrap, omdat daar een verhoogd valrisico bestaat!
- Trappen mogen alleen met ondersteuning van hulppersonen worden beklommen, voor zover er geen lift of hellingbanen aanwezig zijn.
- De lagers in de wielen kunnen beschadigd raken door inwerking van zand, zeewater of strooizout. Als u deze omstandigheden met de rollator bent tegengekomen, moet u deze daarna grondig reinigen.
- Rails en dergelijke obstakels moet u, als u deze niet kunt ontwijken, altijd in een rechte hoek (90°) oversteken.
- De rollator mag niet worden gebruikt voor het vervoeren van zware goederen. Voorwerpen mogen alleen in de mand worden vervoerd, zoals is beschreven in hoofdstuk 'Accessoires'.
- Ernstige incidenten met de rollator moeten aan de fabrikant en de verantwoordelijke instanties worden gemeld.
- Als u een functiebeperking bij uw rollator vaststelt, breng deze dan onmiddellijk voor reparatie naar uw geautoriseerde vakhandelaar.
- Voorafgaand aan de ingebruikneming na opslag langer dan een jaar moeten alle in het onderhoudsplan vereiste inspecties worden uitgevoerd.
- Als u een product op maat hebt (zie het hoofdstuk "Productkenmerking") dienen behalve de gewone gebruiksaanwijzing ook de bijkomende documentatie incl. alle veiligheidsinstructies in acht te worden genomen.

REPARATIE/ONDERHOUD

Ter garantie van een veilig gebruik van de rollator adviseren wij om de controles volgens het onderhoudsplan regelmatig uit te voeren.
Als de verzorging en het onderhoud van de rollator gebrekkig is of wordt verwaarloosd, leidt dat tot beperking van de aansprakelijkheid. Het onderhoudsplan geeft geen uitsluitsel over de daadwerkelijk benodigde bij de rollator vastgestelde omvang van de werkzaamheden.

OPMERKING

Als gebruiker merkt u mogelijke schades als eerste. Als u een defect zoals is genoemd in het onderhoudsplan, of eventuele andere defecten of functiebeperkingen vaststelt, verzoeken wij u om onmiddellijk contact op te nemen met een geautoriseerde vakhandelaar.

WAARSCHUWING

Om de bedrijfsveiligheid van de rollator te behouden, mogen reparaties uitsluitend door de vakhandel en met gebruik van DIETZ-reserveonderdelen worden uitgevoerd. De betreffende reserveonderdelenlijst is beschikbaar op onze website.

OPMERKING

De in het onderhoudsplan vereiste inspecties en maatregelen moeten, indien niet anders is vermeld, door de gebruiker of door een helper worden uitgevoerd.

OPMERKING VOOR VAKHANDELAARS

Als de gebruiker onregelmatigheden bij de rollator meldt, vragen we u om alle controlepunten in het onderhoudsplan na te lopen. De controles moeten ook voor elke heringebruikname en na langere productopslag (> 4 maanden) worden uitgevoerd.

ONDERHOUDSSCHEMA XXL-ROLLATOR

Te controleren	Omschrijving	maandelijks	voor gebruik
Remmen: Functie	Met naar beneden gedrukte/geblokkeerde remhendels (blokkeerrem) of aangetrokken remhendels (bedrijfsrem) mogen de achterwielen niet kunnen draaien. De remmen moeten opnieuw worden ingesteld als de remkabels of de achterwielen zijn vervangen. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerde vakhandelaar worden uitgevoerd.	x	

Te controleren	Omschrijving	maandelijks	voor gebruik
Schuifhandvatten: Stabiliteit	1. De schroeven op de schuifhandvatten moeten stevig kunnen worden vastgezet. 2. De schuifhandvatten mogen niet wiebelen.	x	
Vastzetten van het inklapmechanisme: Functie en veiligheid	1. De rollator is correct uitgeklapt als de zitting volledig omlaag is gedrukt en plat of het frame ligt. Als de zitting omlaag wordt gedrukt, klikt deze hoorbaar vast. 2. De beide framedelen moeten zonder problemen in elkaar en uit elkaar kunnen worden geschoven.	x	
Schroef-verbindingen: stevig vastzitten	Alle schroefverbindingen moeten stevig vastzitten. Zelfborgende moeren en schroeven verliezen hun effectiviteit na herhaaldelijk los- en vastschroeven. Daarom moeten deze door een geautoriseerde vakhandelaar worden vervangen als deze los blijken te zitten.	x	
Zwenk- en loopwielen: Gangbaarheid, functie en beschadigingen	1. De wielen moeten in een rechte lijn lopen en mogen niet wiebelen. 2. De wielen moeten tijdens het rijden licht en geluidloos bewegen. 3. De wielen mogen geen beschadigingen vertonen.	x	
Zwenk- en loopwielen: Gangbaarheid, functie en beschadigingen	1. De wielen mogen geen beschadigingen vertonen en moeten geluidloos, zonder wiebelen en rechtlijnig lopen. 2. Reinig de wielen als er zich pluizen of vuil in de wielnaven bevinden.		x
Schuifhandvatten: Stabiliteit en beschadigingen	1. De handvatten en remhendels moeten goed vastzitten. 2. De schuifhandvatten mogen geen uiterlijke beschadigingen/ verbuigingen vertonen en mogen niet wiebelen. 3. De schroeven moeten goed kunnen worden vastgeschroefd.		x
Zitting: Vervuiling en beschadigingen	1. De zitting moet op het frame zijn vastgezet. 2. Reinig het zittingoppervlak indien vervuild conform de reinigingsinstructies. 2. Bij beschadigingen moet de zitting worden vervangen.		x
Frame, volledig: Functie en beschadigingen	1. Op de beide framedelen en de scharnieren mogen geen beschadigingen of scheuren zichtbaar zijn. 2. Eventuele functionele of oppervlakteschade moet worden hersteld.		x
Visuele controle: losse onderdelen, breuken, corrosie of andere schade	Als dergelijke schade wordt vastgesteld, mag de rollator niet meer worden gebruikt, omdat een veilig rijgedrag niet meer is gegarandeerd!		x
Vervuiling: Rollator, volledig:	Afhankelijk van de vervuilingsgraad, maar ten minste maandelijks, moet de gehele rollator worden gereinigd (zie hoofdstuk Reiniging).		x

STORINGEN ZOEKEN EN VERHELPEN

Wat	Mogelijke oorzaken	Maatregelen
De voorwielen lopen niet in een rechte lijn.	De wiellagers zijn defect of de wielophanging zit niet meer goed vast.	Neem contact op met een geautoriseerde vakhandelaar
De rollator loopt zwaar.	De wielassen/wielnaven zijn vervuild.	Verwijder de vervuiling
	De remmen zijn onjuist ingesteld.	Neem contact op met een geautoriseerde vakhandelaar
	De wiellagers zijn defect of de wielophanging zit niet meer goed vast.	
De remfunctie is onvoldoende of ongelijkmatig.	De remmen zijn onjuist ingesteld of de remblokken zijn versleten.	Neem contact op met een geautoriseerde vakhandelaar
De zitting is niet goed vastgezet op de rollator of loopt scheef.	De rollator is niet volledig uitgeklapt.	Klap de rollator volledig uit zodat de zitting vastklikt wanneer deze omlaag wordt gedrukt.
	De zitting zit niet goed vast op het frame of de zitting is defect.	Neem contact op met een geautoriseerde vakhandelaar
	De scharnieren zijn defect.	
Piepende en schurende geluiden	Diverse oorzaken	Neem contact op met een geautoriseerde vakhandelaar
De rollator biedt onvoldoende steun of staat niet stabiel.	De schuifhandvatten zijn onjuist vastgezet of niet goed op de gebruiker ingesteld.	Controleer de hoogte van de schuif-handvatten
		Controleer of de sterschroeven van de schuifhandvatten goed vastzitten
	De rollator is niet volledig uitgeklapt en de zitting is niet vastgeklikt.	Klap de rollator volledig open en zorg ervoor dat de zitting op het frame vastklikt
	Het rollatorframe of de schuifhandvatten is/zijn beschadigd.	Neem contact op met een geautoriseerde vakhandelaar

REINIGING

- Het reinigen bestaat onder andere uit het regelmatig afvegen van de framedelen van de rollator met een vochtige poetsdoek. Bij sterkere vervuiling kunt u een mild schoonmaakmiddel en warm water gebruiken.
- De bekleding van de zitting kan worden schoongemaakt met een milde zeepoplossing en een spons.
- De wielen kunnen met een vochtige kunststof borstel worden schoongemaakt.
- Verwijder vuil en pluizen uit de wielnaven.
- Gebruik uitsluitend in de normale handel verkrijgbare milde reinigings- en desinfectieproducten. In het volgende hoofdstuk vindt u meer informatie over desinfectie.

WAARSCHUWING

Gebruik voor het schoonmaken geen hogedrukreiniger, geen agressieve, bijtende chemicaliën en geen schuurmiddelen.

WAARSCHUWING

Let er na het schoonmaken op dat alle materialen volledig droog zijn, ter behoud van de kwaliteit.

DESINFECTIE

Bij handmatige schoonmaak van een gebruikt hulpmiddel moeten alle onderdelen grondig worden behandeld met een geschikt oppervlakdesinfectiemiddel. Oppervlakken met regelmatig hand- of huidcontact, zoals de handvatten, moeten bijzonder zorgvuldig worden gedesinfecteerd.

WAARSCHUWING

Volg bij het desinfecteren de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de reinigings- en desinfectiemiddelen.

De volgende desinfectiemiddelen zijn geschikt voor de materialen:

- Aldehydevrije desinfectie op basis van alcohol (max. 70% propylalcohol)
- Desinfectiemiddelen op basis van aldehyde

DOORGIFTE EN HERGEBRUIK

Tenzij uw product op maat is gemaakt, kan het worden doorgegeven/hergebruikt.

Hoe vaak een product kan worden hergebruikt, hangt af van de slijtagetoestand en de functionaliteit van het betreffende product.

Als een rollator wordt doorgegeven aan en wordt hergebruikt door een nieuwe gebruiker of een vakhandelaar, moet u eraan denken dat u ook alle voor een veilig gebruik benodigde documentatie overhandigt.

Voordat de rollator wordt hergebruikt, moet deze door een vakhandelaar worden schoongemaakt, gedesinfecteerd en gecontroleerd.
Hiertoe moeten alle in het onderhoudsplan genoemde controlepunten bij de rollator worden uitgevoerd.

OPSLAG

Als u de rollator wilt opslaan, moet u erop letten dat deze droog, beschermd tegen sterkte zoninstraling en bij
een temperatuur van 0 °C tot +45 °C wordt opgeslagen. Schakel de blokkeerremmen niet in en beveilig de rollator tegen onbedoeld wegrollen.
Na een langere opslagduur (> 4 maanden) moeten bij een hernieuwde ingebruikname alle in het onderhoudsplan genoemde controlepunten bij de rollator worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING

Sla de rollator niet op in de buurt van warmtebronnen en leg tijdens de opslag geen voorwerpen op de rollator.

RECYCLING

Als u de rollator niet meer nodig hebt, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw vakhandelaar. Deze zal de rollator ophalen en vakkundig afvoeren of geschikt maken voor hergebruik. Als dit niet mogelijk is, kunt u de rollator naar uw plaatselijke milieustraat brengen.

PRODUCTKENMERKING

Het typeplaatje en overige eventueel aanwezige kenmerkingen moeten te allen tijde leesbaar zijn.
Laat onleesbare of ontbrekende plaatjes/stickers direct door uw vakhandelaar vervangen. Hierbij horen tevens de eventuele reflecterende stickers.
Bij de XXL-rollator bevindt het typeplaatje zicht op de horizontale verbindingsstang op het achterste framedeel.
In de hierna volgende opsomming worden de symbolen en gegevens op het typeplaatje nader verklaard. (Het hier afgebeelde typeplaatje dient als voorbeeld.) Op het typepaatje is tevens het serienummer van uw rollator vermeld.

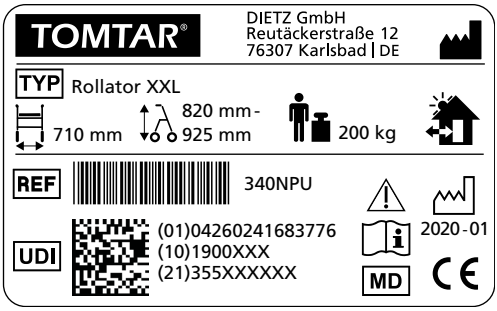

TOMTAR®	Handelsmerk
TYP	TYPE/MODEL
REF	REF = artikelnummer
UDI	UDI = Unique Device Identifier (01) UDI-DI / GTIN (10) Bestelnummer (21) serienummer

	Fabrikant/fabrikantsymbool/ contactadres
	Maximum gebruikersgewicht incl. belading
	Productiedatum
	Totale breedte rollator
	Totale hoogte (min. – max.) Rollator
	De rollator kan binnen en buiten worden gebruikt.
	Gebruiksaanwijzing naleven
	Let op: Veiligheidsinstructies zijn in de gebruiksaanwijzing vermeld!
	Medical Device / medisch product
	CE-markering

Bij producten met de volgende kenmerking betreft het een op maat gemaakt product:

SONDERANFERTIGUNG
CUSTOM-MADE DEVICE

Producten op maat zijn producten die speciaal voor een specifieke gebruiker zijn vervaardigd. In dat geval wijken het typeplaatje, de waarschuwingen en eventueel het beoogd gebruik af. De aanvullende documentatie moet in acht worden genomen!

GARANTIE

De garanties hebben betrekking op alle gebreken aan het product, die aantoonbaar het gevolg zijn van materiaal- of productiefouten.
De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf ontvangst van de melding van de verzending, uiterlijk na levering.
Uitgesloten van de garantieverplichting zijn beschadigingen die zijn ontstaan door slijtage, opzet, nalatigheid of ondoelmatige bediening of gebruik. Hetzelfde geldt bij gebruik van ongeschikte onderhoudsproducten, smeeroliën en vetten.

LEVENSDUUR

De te verwachten levensduur bedraagt vijf jaar, uitgaande van dagelijks gebruik conform het beoogde gebruiksdoel. Voorwaarde hiervoor is dat de onderhouds-, reinigings- en veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing worden nageleefd.

AANSPRAKELIJKHEID

DIETZ GmbH aanvaardt alleen aansprakelijkheid als de producten onder de voorgeschreven voorwaarden voor het voorgeschreven gebruiksdoel worden gebruikt. Wij adviseren de producten zorgvuldig te onderhouden en te verzorgen zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven. Voor schades veroorzaakt door (vervangende) onderdelen die niet door DIETZ GmbH zijn geautoriseerd, is DIETZ GmbH niet aansprakelijk. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde vakhandelaren of door de fabrikant zelf worden uitgevoerd.

AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

Aanduiding		**Eenheid**	**XXL-rollator**
Artikelnummer			340NPU
Materiaal/kleur: Frame			Aluminium / zilver
Materiaal/kleur/afmetingen: Wielen		mm	Rubber (EVA) / zwart / 200 × 30
Materiaal/kleur: Remhendels			Polyamide met glasvezel
Materiaal/kleur: Handvatten			TPE (thermoplastisch elastomeer)/zwart
Materiaal/kleur: Zitting			PUR-schuim/zwart
Materiaal/kleur: Rugbeugel			Schuim, zwart en aluminium stang
Materiaal/kleur: Mandje			Staal, gepoedercoat/zwart
Lengte / Breedte / Hoogte		mm	730 / 710 / 820
Lengte / Breedte / Hoogte (gemonteerd met rugbeugel schuifhandvatten laagste stand) ingeklapt		mm	865 / 718 / 635
Lengte / Breedte / Hoogte (zonder rugbeugel en schuifhandvatten) ingeklapt		mm	720 / 718 / 515
Zithoogte		mm	540
Zitdiepte/zitbreedte (ruimte tussen schuifhandvatten)		mm	340 / 600
Totale hoogte min./max.		mm	820 / 925
Handvathoogte, verstelbaar		mm	50 × 20
Draaibreedte		mm	935
Kantelstabiliteit conform EN ISO 11199-2	voorwaarts	°	20
	achterwaarts	°	7,5
	zijwaarts	°	8
Gewicht met mandje		kg	12
Max. Gebruikersgewicht incl. belading en hulpstukken		kg	200
Max. Belastbaarheid mandje		kg	3
Aanbevolen lichaamslengte		m	1,60 / 1,85

PRODUCTCONTROLES

Complete test conform rollatornorm	EN ISO 11199-2
Biocompatibiliteit van de kunststof elementen	ISO 10993

OMGEVINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur bij gebruik	-10 °C tot +50 °C
Omgevingsvoorwaarden bij opslag	0 °C tot 45 °C | 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid

BEPALING VAN DE IDENTIFICATIEGEGEVENS

We adviseren u om de identificatiegegevens van uw product over te nemen van het typeplaatje en op de volgende regels in te vullen, zodat u deze bij de hand hebt als wij contact met u opnemen. (Zie de toelichting in het hoofdstuk "Productkenmerking".)*

TYP Type/model:	
REF Artikelnr. /REF:	
UDI Serienummer (21):	
Productiedatum:	
Overige gegevens/ aantekeningen:	

* Bij producten op maat kunnen de identificatiegegevens of het typeplaatje afwijken

TOMTAR®

Productgroep: Rollators
Product: XXL-rollator
Gebruiksaanwijzing versie 5.0.0 NL (MSC)
Versie 02-2020

CE

TOMTAR is een geregistreerd merk van DIETZ GmbH.

DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad (Duitsland)

Tel.: +49 7248.9186-0
Fax: +49 7248.9186-86
info@dietz-reha.de
www.dietz-rehab.de

Onder voorbehoud van drukfouten, vergissingen en prijs- en productwijzigingen.
© DIETZ GmbH Reha-Produkte, Karlsbad (Duitsland)
Verveelvoudiging, ook deels, uitsluitend met schriftelijke toestemming van
DIETZ GmbH, Karlsbad.